

**PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO**  
**9.2 MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO**

Nombre de la institución	E.S.E CLINICA GUANE Y SU RIS		
Dirección	Calle 4 #7 -01	Municipio	FLORIDABLANCA
Fecha de Elaboración	ABRIL 2025	Vigencia	2025
Recursos asignados para el Mantenimiento Hospitalario	1.018.013.000		
Recursos asignados para el Mantenimiento Dotación Hospitalaria	509.006.500		
Recursos asignados para el Mantenimiento Infraestructura Hospitalaria	509.006.500		

**9.2 MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO**

Nombre del equipo	Localización	Nº de Inventario	Periodicidad	Fecha			Responsable (s)	Actividades
				DD	MM	AA		
9.2.1 Equipo para Lavandería y Cocina								
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9.2.2 Equipo para Esterilización y Autoclaves								
AUTOCLAVE	ESTERILIZACION CLINICA GUANE	1608	SEMESTRAL	-	ABRIL OCTUBRE	2025	CONTRATISTA	INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA, INSPECCIÓN VISUAL INTERNA DE LA CÁMARA, REVISIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS, REVISIÓN DE PARTES MECÁNICAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIA, AJUSTE DE RACORES Y TUBERÍAS, REVISIÓN DE ELECTROVÁLVULAS, REVISIÓN DE MANÓMETROS, REVISIÓN TOMA DE AGUA Y CONTENEDOR, PRUEBAS FUNCIONALES FINALES Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.
AUTOCLAVE	ESTERILIZACION CLINICA GUANE	3291	SEMESTRAL	-	ABRIL OCTUBRE	2025	CONTRATISTA	INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA, INSPECCIÓN VISUAL INTERNA DE LA CÁMARA, REVISIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS, REVISIÓN DE PARTES MECÁNICAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIA, AJUSTE DE RACORES Y TUBERÍAS, REVISIÓN DE ELECTROVÁLVULAS, REVISIÓN DE MANÓMETROS, REVISIÓN TOMA DE AGUA Y CONTENEDOR, PRUEBAS FUNCIONALES FINALES Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.
AUTOCLAVE	ESTERILIZACION	2492		-	ABRIL	2025	CONTRATISTA	INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA, INSPECCIÓN

  
 DIRECTOR GERENTE


  
 JEFE DE ALMACEN


	CLINICA GUANE		SEMESTRAL		OCTUBRE			VISUAL INTERNA DE LA CÁMARA, REVISIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS, REVISIÓN DE PARTES MECÁNICAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIA, AJUSTE DE RACORES Y TUBERÍAS, REVISIÓN DE ELECTROVÁLVULAS, REVISIÓN DE MANÓMETROS, REVISIÓN TOMA DE AGUA Y CONTENEDOR, PRUEBAS FUNCIONALES FINALES Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.
AUTOCLAVE	ODONTOLOGIA CUMBRE	2035	SEMESTRAL	-	MARZO - SEPTIEMBRE	2025	CONTRATISTA	INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA, INSPECCIÓN VISUAL INTERNA DE LA CÁMARA, REVISIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS, REVISIÓN DE PARTES MECÁNICAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIA, AJUSTE DE RACORES Y TUBERÍAS, REVISIÓN DE ELECTROVÁLVULAS, REVISIÓN DE MANÓMETROS, REVISIÓN TOMA DE AGUA Y CONTENEDOR, PRUEBAS FUNCIONALES FINALES Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.
AUTOCLAVE	ODONTOLOGIA JOSE A MORALES	2368	SEMESTRAL	-	ABRIL - OCTUBRE	2025	CONTRATISTA	INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA, INSPECCIÓN VISUAL INTERNA DE LA CÁMARA, REVISIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS, REVISIÓN DE PARTES MECÁNICAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIA, AJUSTE DE RACORES Y TUBERÍAS, REVISIÓN DE ELECTROVÁLVULAS, REVISIÓN DE MANÓMETROS, REVISIÓN TOMA DE AGUA Y CONTENEDOR, PRUEBAS FUNCIONALES FINALES Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.
AUTOCLAVE	ODONTOLOGIA VILLABEL	1718	SEMESTRAL	-	MAYO - NOVIEMBRE	2025	CONTRATISTA	INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA, INSPECCIÓN VISUAL INTERNA DE LA CÁMARA, REVISIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS, REVISIÓN DE PARTES MECÁNICAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIA, AJUSTE DE RACORES Y TUBERÍAS, REVISIÓN DE ELECTROVÁLVULAS, REVISIÓN DE MANÓMETROS, REVISIÓN TOMA DE AGUA Y CONTENEDOR, PRUEBAS FUNCIONALES FINALES Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.

AUTOCLAVE	ODONTOLOGIA TRINIDAD	1803	SEMESTRAL	-	JUNIO DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	DEL EQUIPO. INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA, INSPECCIÓN VISUAL INTERNA DE LA CÁMARA, REVISIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS, REVISIÓN DE PARTES MECÁNICAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIA, AJUSTE DE RACORES Y TUBERÍAS, REVISIÓN DE ELECTROVÁLVULAS, REVISIÓN DE MANÓMETROS, REVISIÓN TOMA DE AGUA Y CONTENEDOR, PRUEBAS FUNCIONALES FINALES Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.
AUTOCLAVE	ODONTOLOGIA REPOSO	1984	SEMESTRAL	-	JUNIO DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA, INSPECCIÓN VISUAL INTERNA DE LA CÁMARA, REVISIÓN DE PARTES ELÉCTRICAS, REVISIÓN DE PARTES MECÁNICAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE RESISTENCIA, AJUSTE DE RACORES Y TUBERÍAS, REVISIÓN DE ELECTROVÁLVULAS, REVISIÓN DE MANÓMETROS, REVISIÓN TOMA DE AGUA Y CONTENEDOR, PRUEBAS FUNCIONALES FINALES Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.
<b>9.2.3 Equipo de Refrigeración y Aire Acondicionado</b>								
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLÉ DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSION DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS,

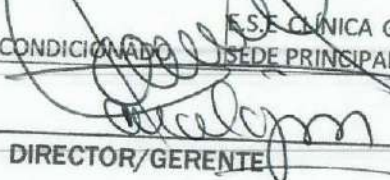
AIRE ACONDICIONADO DE  
24000 MINISPLIT SAM  
SUNG

SEDE CUMBRE

  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE ALMACEN

							REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.
			BIMENSUAL		2025	CONTRATISTA	
				ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE			REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLÉ DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSION DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU COMPRESOR CONSTANTE H-220 60HS/1HP	SEDE VILLABEL		BIMENSUAL		2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLÉ DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSION DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.
AIRE ACONDICIONADO	SEDE PRINCIPAL		BIMENSUAL		2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLÉ DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSION DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.

  
 DIRECTOR/GERENTE

  
 JEFE DE ALMACEN




									PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLA DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSION DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA		REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLA DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSION DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.


AIRE ACONDICIONADO  
MINISPLIT 12,000BTU SEDE TRINIDAD

  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE ALMACEN


AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12,000BTU	SEDE JOSE A. MORALES	BIMENSUAL	-	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLÉ DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSION DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.
AIRE ACONDICIONADO DEE.S.A CLÍNICA GUANE 12.000 BTU	SEDE PRINCIPAL	BIMENSUAL	-	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLÉ DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSION DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN

  
DIRECTOR GERENTE

  
JEFE DE ALMACEN

								E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLÉ DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSIÓN DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN
AIRE ACONDICIONADO	E.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL							E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLÉ DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSIÓN DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES,
AIRE ACONDICIONADO 24W	E.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL							REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES,

  
 DIRECTOR GERENTE

  
 JEFE DE ALMACEN

							VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLÉ DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSIÓN DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.
AIRE ACONDICIONADO	E.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL		BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN
AIRE ACONDICIONADO	E.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL		BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN

AIRE ACONDICIONADO E.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL

DIRECTOR GERENTE

JEFE DE ALMACEN

							GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLA DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSION DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLA DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSION DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.
AIRE ACONDICIONADO E.S.E CLÍNICA GUANE MINISPLIT DE 12000 LG SEDE PRINCIPAL							
AIRE ACONDICIONADO E.S.E CLÍNICA GUANE MINI SPLIT 12000 BTU COMPRESOR CONSTANTE H-220 60HS/1HP SEDE PRINCIPAL			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE	2025	CONTRATISTA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA,

  
DIRECTOR GERENTE

  
JEFE DE ALMACEN

					DICIEMBRE			LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSION DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSION DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL

AIRE ACONDICIONADO S.E CLÍNICA GUANE  
COMFORTSTAR SEDE PRINCIPAL

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE ALMACEN

			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	SERPENTÍN EVAPORADOR. REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOUPLE DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSIÓN DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.
AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU	LGE.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL		BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOUPLE DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSIÓN DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS.


AIRE ACONDICIONADO  
MINI SPLIT 12000 BTU  
LG

HE.S.E CLÍNICA GUANE  
SEDE PRINCIPAL

  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE ALMACEN

							ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU/H CONFORT STAR	H.E.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL						REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLA DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSIÓN DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA
AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12000 BTU/H UCP 220V SAMSUNG	H.E.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL						REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLA DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSIÓN DE CORREAS (SI APLICA),

  
DIRECTOR GERENTE

  
JEFE DE ALMACEN





SAMSUNG CON CONTROL					AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE		INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLA DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSIÓN DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLA DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSIÓN DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE

AIRE ACONDICIONADO (S) SEDE VILLABEL

  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE ALMACEN

								MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLA DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSIÓN DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.
AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 18000 BTU/H DELTA INVERTER R410A	H.E.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL							
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLA DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSIÓN DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS,
AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU/H SAMSUNG	H.E.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL							REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS,

AIRE ACONDICIONADO H.E.S.E CLÍNICA GUANE  
18000 BTU/H SAMSUNG SEDE PRINCIPAL

  
DIRECTOR GERENTE

  
JEFE DE ALMACEN

							REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA
AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12000 BTU/H UCP 220V SAMSUNG	E.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL						REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSIÓN DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA
AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU/H SAMSUNG	E.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL						REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y

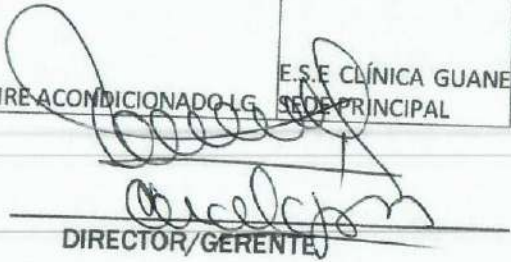
  
DIRECTOR GERENTE

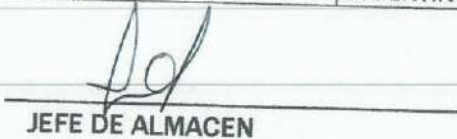
  
JEFE DE ALMACEN



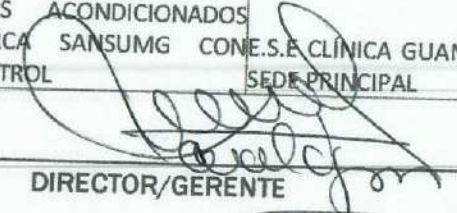
								PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLÉ DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSION DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLÉ DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSION DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.

AIRE ACONDICIONADO I.G. E.S.E CLÍNICA GUANE  
SEDE PRINCIPAL

  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE ALMACEN

			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSIÓN DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.
AIRE ACONDICIONAD LG	SEDE CUMBRE							
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSIÓN DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN
AIRES ACONDICIONADOS MARCA SANSUMG CONTROL	SEDE PRINCIPAL							CLÍNICA GUANE

  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE ALMACEN

							E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU/H UCP 220v SAMSUNG	H.E.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL						REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLÉ DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSION DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA
AIRE ACONDICIONADOS MARCA SANSUMG CONTROL	H.E.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL						E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR. REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLÉ DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSION DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES,

AIRE ACONDICIONADOS  
MARCA SANSUMG  
CONTROL

H.E.S.E CLÍNICA GUANE  
SEDE PRINCIPAL

DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE ALMACEN


							VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA
AIRE ACODICIONADO LG	E.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL						REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLÉ DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSIÓN DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU/H WIND-FREE SAMSUNG INVERTER	E.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL		BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA
							REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN

  
DIRECTOR GERENTE

  
JEFE DE ALMACEN

							GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSION DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.	
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSION DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BTU/H UCP 220v LG	E.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL							
AIRE ACONDICIONADO	E.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL		BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA,

  
DIRECTOR GERENTE

  
JEFE DE ALMACEN

					DICIEMBRE			LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLÉ DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSIÓN DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLÉ DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSIÓN DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL

AIRE ACONDICIONADO  
MINI SPLIT 12000 BTU/H  
UCP 220V SAMSUNG CONE.S.E CLÍNICA GUANE  
CONTROL SEDE PRINCIPAL

DIRECTOR GERENTE

JEFE DE ALMACEN

			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	SERPENTÍN EVAPORADOR. REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA, LAVADO O REEMPLAZO DE FILTROS DE AIRE (SEGÚN CORRESPONDA), LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTINES, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, REVISIÓN Y AJUSTE TENSION DE CORREAS (SI APLICA), AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, REVISIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN E ILUMINACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL SERPENTÍN EVAPORADOR.
AIRE ACODICIONADO 12000	LGE.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL		BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE

NEVERA HORIZONTAL  
VESTFROST-DENMARK SEDE CUMBRE

DIRECTOR GERENTE

JEFE DE ALMACEN

								VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
NEVERA	SEDE CUMBRE							
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
NEVERA	E.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL							

  
DIRECTOR GERENTE

  
JEFE DE ALMACEN

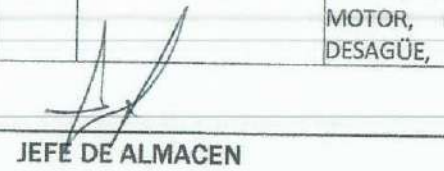
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
NEVERA ABBA CENTRALES NACIONAL 10 PIES- 304 LITROS	SEDE CUMBRE							
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
NEVERA PHILLIPS	SEDE CUMBRE							
NEVERA 235 LITROSE SE CLÍNICA GUANE CENTRALES CON BASE 3	SEDE PRINCIPAL		BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA

  
DIRECTOR GERENTE

  
JEFE DE ALMACEN

					OCTUBRE DICIEMBRE			OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
Nevera	SEDE CUMBRE		BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
NEVERA CENTRALES	SEDE VILLABEL		BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE

  
DIRECTOR GERENTE

  
JEFE DE ALMACEN

							SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.	
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
NEVERA ABBAT	SEDE VILLABEL							
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL,
	E.S.E CLÍNICA GUANE							
NEVERA PHILIPS ESTÁNDAR	SEDE PRINCIPAL							

  
DIRECTOR GERENTE

  
JEFE DE ALMACEN

							REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.	
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
NEVERA VERTICAL HACEB	SEDE CUMBRE							
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU

NEVEREA HACEB vertical  
268 litros - fija para E.S.F CLÍNICA GUANE  
Laboratorio Clínico SEDE PRINCIPAL

DIRECTOR GERENTE

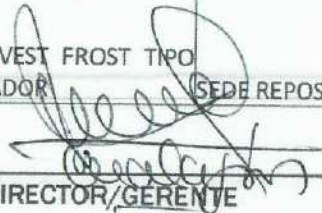
JEFE DE ALMACEN

							OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.	
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
NEVERA DE 10 PIES HACEB	SEDE VILLABEL							
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
NEVERA ABBAT 130 LTS	SEDE VILLABEL							

  
 DIRECTOR/GERENTE

  
 JEFE DE ALMACEN

								CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
NEVERA ABBAT 130 LTS + TERMOMETRO DIGITAL NEVERA	E.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL							
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
NEVERA VEST FROST TIPO CONGELADOR	SEDE REPOSO							

  
 DIRECTOR, GERENTE

  
 JEFE DE ALMACEN

								ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLÉ DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
NEVERA CENTRAL	SEDE REPOSO							
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLÉ DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
NEVERA ABBAC PEQUEÑA	SEDE REPOSO							

NEVERA ABBAC PEQUEÑA, SEDE REPOSO

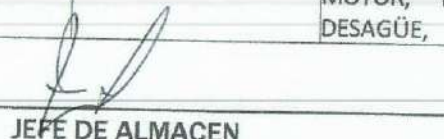
DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE ALMACEN

			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLA DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
NEVERA VERTICAL HACER ASF 272	SEDE TRINIDAD		BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLA DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
NEVERA ABBAT 130 LTS CON TERMOMETRO	SEDE TRINIDAD		BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLA DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
NEVERA VERTICAL HACER	SEDE JOSE A MORALES		BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA

					OCTUBRE DICIEMBRE			OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
NEVECON DEMARK	VESTFROST	E.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL						
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE
NEVERA VERTICAL HAGER		SEDE JOSE A MORALES						

  
DIRECTOR GERENTE

  
JEFÉ DE ALMACEN

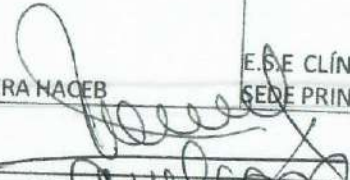
							SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.	
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
NEVERA (SEGUNDO PISO)	E.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL		BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
NEVERA BEIGE (PRIMERO PISO)	E.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL		BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL,


NEVERA BEIGE (PRIMERO PISO) E.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL

DIRECTOR GERENTE

JEFE DE ALMACEN

								REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLA DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
NEVERA CENTRALES	E.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL		BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLA DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
NEVERA HACER	E.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL		BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLA DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU

  
 DIRECTOR/GERENTE

  
 JEFE DE ALMACEN


							OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA
NEVERA LABORATORIO	PHILIPSE.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL						REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA
NEVERA NACIONAL 10 PIES- 304 LITROS + TERMOMETRO	CENTRALES S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL						REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE

DIRECTOR GERENTE

JEFE DE ALMACEN

										CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025		CONTRATISTA		REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
NEVERA HIELERA AZUL GRANDE		E.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL								
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025		CONTRATISTA		REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
NEVERA HIELERA PEQUEÑA GRANDE		E.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL								

  
 DIRECTOR/GERENTE

  
 JEFE DE ALMACEN


									ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA		REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
NEVERA HACEB DOSE.S.E CLÍNICA GUANE PUERTAS SEDE PRINCIPAL									
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA		REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
NEVERA CENTRALES, CONE.S.E CLÍNICA GUANE TERMOMETRO SEDE PRINCIPAL									

NEVERA CENTRALES, CONE.S.E CLÍNICA GUANE  
TERMOMETRO SEDE PRINCIPAL

DIRECTOR/GERENTE


JEFE DE ALMACEN

NEVERA HORIZONTAL VESTFROST-DENMARK, CON TERMOMETRO	E.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL	BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
NEVERA HORIZONTAL VESTFROST-DENMARK, CON TERMOMETRO	E.S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL	BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
NEVERA HORIZONTAL VESTFROST-DENMARK, CON TERMOMETRO	SEDE JOSE A MORALES	BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA

  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE ALMACEN

					OCTUBRE DICIEMBRE			OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.
NEVERA CENTRALES DE 10 PIES	SEDE JOSE A MORALES							
NEVERA CENTRALES 235 LTS	S.E CLÍNICA GUANE SEDE PRINCIPAL		BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS EQUIPOS, QUE CONSISTE EN: INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE MOTOR, LIMPIEZA DE BANDEJA DE DESAGÜE, LIMPIEZA Y PEINADO DE

  
DIRECTOR GERENTE

  
JEFE DE ALMACEN

SERPENTIN, LIMPIEZA DE BANDEJAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DEL ROTOR DEL VENTILADOR, LUBRICACIÓN EN GENERAL, REVISIÓN DEL ALINEAMIENTO DEL ACOPLE DE LOS MOTORES, AJUSTE TORNILLOS DE ENSAMBLE, VERIFICACIÓN DE SU OPERACIÓN, REVISIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS. LIMPIEZA DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, BIMETÁLICOS DE PROTECCIÓN, TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE MOTORES ELÉCTRICOS, DETERMINAR TEMPERATURAS DEL CONGELADOR O DEL REFRIGERADOR.

9.2.4 Calderas, Bombas, Plantas Eléctricas

BIMENSUAL

ABRIL  
JUNIO  
AGOSTO  
OCTUBRE  
DICIEMBRE

2025

CONTRATISTA

COLOCAR EN MODO MANUAL LA PLANTA ELÉCTRICA DURANTE EL MANTENIMIENTO PARA EVITAR ACCIDENTES, LIMPIAR CUALQUIER SUCIEDAD O FLUIDOS QUE EXISTAN SOBRE LA SUPERFICIE, REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN, REVISAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DEL MOTOR, REVISAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DEL GENERADOR, REVISAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DEL TOTALIZADOR DE SALIDA, LIMPIAR (SOPLATEAR) EL FILTRO DE AIRE, REVISAR Y LIMPIAR EL RESPIRADERO DEL CARTER, REVISAR SELLO DEL TAPÓN DEL CARTER, VERIFICAR EL NIVEL DE ACEITE EN EL CARTER, REVISAR TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE, ENCENDER LA PLANTA ELÉCTRICA CON CARGA (OPCIONAL), REALIZAR PRUEBAS PARA COMPROBAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE PAROS Y ALARMAS, REVISAR NIVEL DE CARGA Y BORNES DE LAS BATERÍAS, AJUSTAR TORNILLERÍA SOPORTE DEL EXHOSTO, VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

PLANTA ELECTRICAE.S.E CLÍNICA GUANE  
HECOHORSE 6700 SEDE PRINCIPAL

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE ALMACEN

								DE ACCELERACIÓN, REVISAR FUNCIONAMIENTO DEL ALTERNADOR, REVISAR CORREA DEL ALTERNADOR, SOPLETEAR EL RADIADOR CON AIRE A PRESIÓN, REALIZAR LIMPIEZA DE RADIADOR, REVISAR NIVEL DE REFRIGERANTE EN EL RADIADOR, VERIFICAR EL NIVEL DE COMBUSTIBLE EN EL TANQUE, REVISAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL PRECALENTADOR, REVISAR SISTEMA DE COMBUSTIBLE, FILTROS Y CONDUCTOS, DRENAR SEDIMENTOS DEL COMBUSTIBLE, REVISAR EL ESTADO DE LAS MANGUERAS DE AGUA DEL MOTOR Y RADIADOR, AJUSTAR LA CANTIDAD DE ACEITE O CAMBIAR SI ES NECESARIO, INSPECCIONAR TEMPERATURA Y PRESIÓN DEL ACEITE, REVISAR EL ESTADO DE LAS MANGUERAS DE ACEITE DEL MOTOR, REVISAR EL ESTADO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, REVISAR EL ESTADO Y TENSIÓN DE LAS CORREAS DEL MOTOR, REVISAR EL ESTADO DE SOPORTE DEL MOTOR, REVISAR EL ESTADO DE LAS MANGUERAS DE DIESEL DEL MOTOR Y TANQUE DE COMBUSTIBLE, LAVAR EL GENERADOR Y PARTES ELÉCTRICAS CON DIALÉCTRICO, REALIZAR LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.
			BIMENSUAL	-	ABRIL JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REVISIÓN TABLERO DE POTENCIA, REVISIÓN DE PLC, REVISIÓN DE PRESOSTATOS, REVISIÓN SISTEMA DE ARRANQUE, REVISIÓN DE GUARDA MOTORES, REVISIÓN DE CONTROL AUTOMÁTICO Y MANUAL, CALIBRACIÓN DE PRESIÓN MÁXIMA, CALIBRACIÓN PRESIÓN MÍNIMA, REVISAR ANCLAJE DE MOTORES, REVISIÓN DE CHEQUES HIDRÁULICOS, REVISIÓN CIERRE DE VÁLVULAS MANUALES, REVISIÓN BORNERA DE MOTORES, REVISIÓN ALINEAMIENTO DE MOTOR BOMBA, REVISIÓN SENTIDO DE

BOMBA DE AGUA

E.S.E CLÍNICA GUANE  
SEDE PRINCIPAL

  
DIRECTOR/GERENTE

  
JEFE DE ALMACEN

9.2.5 Otros Industriales de Uso Hospitalario							GIRO.
COMPRESOR	ODONTOLOGIA CLINICA GUANE	NR	SEMESTRAL	-	MARZO - SEPTIEMBRE	2025	CONTRATISTA REVISIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y CABLE A.C, INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA E INTERNA, VERIFICAR LA VÁLVULA DE SEGURIDAD, INSPECCIÓN DEL FILTRO DE AIRE, VERIFICAR EL PRESOSTATO, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, REVISIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO, REVISIÓN DE INDICADORES DE PRESIÓN MODULO, REVISIÓN DE MANÓMETROS DE PRESIÓN, VERIFICAR LA TENSIÓN DE LA CORREA, CAMBIAR EL FILTRO DEL CARTER SI ESTA OBSTRUIDO, PRUEBAS FUNCIONALES FINALES Y LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO.
COMPRESOR	ODONTOLOGIA CUMBRE	806	SEMESTRAL	-	MARZO - SEPTIEMBRE	2025	CONTRATISTA REVISIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y CABLE A.C, INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA E INTERNA, VERIFICAR LA VÁLVULA DE SEGURIDAD, INSPECCIÓN DEL FILTRO DE AIRE, VERIFICAR EL PRESOSTATO, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, REVISIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO, REVISIÓN DE INDICADORES DE PRESIÓN MODULO, REVISIÓN DE MANÓMETROS DE PRESIÓN, VERIFICAR LA TENSIÓN DE LA CORREA, CAMBIAR EL FILTRO DEL CARTER SI ESTA OBSTRUIDO, PRUEBAS FUNCIONALES FINALES Y LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO.
COMPRESOR	ODONTOLOGIA JOSE A MORALES	2181	SEMESTRAL	-	ABRIL - OCTUBRE	2025	CONTRATISTA REVISIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y CABLE A.C, INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA E INTERNA, VERIFICAR LA VÁLVULA DE SEGURIDAD, INSPECCIÓN DEL FILTRO DE AIRE, VERIFICAR EL PRESOSTATO, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, REVISIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO, REVISIÓN DE INDICADORES DE PRESIÓN MODULO, REVISIÓN DE MANÓMETROS DE PRESIÓN, VERIFICAR LA TENSIÓN DE LA CORREA, CAMBIAR EL FILTRO DEL CARTER SI ESTA OBSTRUIDO, PRUEBAS FUNCIONALES FINALES Y LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO.

  
\_\_\_\_\_  
DIRECTOR/GERENTE

  
\_\_\_\_\_  
JEFE DE ALMACEN

COMPRESOR	ODONTOLOGIA VILLABEL	2002	SEMESTRAL	-	MAYO NOVIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REVISIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y CABLE A.C, INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA E INTERNA, VERIFICAR LA VÁLVULA DE SEGURIDAD, INSPECCIÓN DEL FILTRO DE AIRE, VERIFICAR EL PRESOSTATO, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, REVISIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO, REVISIÓN DE INDICADORES DE PRESIÓN MODULO, REVISIÓN DE MANÓMETROS DE PRESIÓN, VERIFICAR LA TENSIÓN DE LA CORREA, CAMBIAR EL FILTRO DEL CARTER SI ESTA OBSTRUIDO, PRUEBAS FUNCIONALES FINALES Y LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO.
COMPRESOR	ODONTOLOGIA TRINIDAD	2170	SEMESTRAL	-	JUNIO DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REVISIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y CABLE A.C, INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA E INTERNA, VERIFICAR LA VÁLVULA DE SEGURIDAD, INSPECCIÓN DEL FILTRO DE AIRE, VERIFICAR EL PRESOSTATO, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, REVISIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO, REVISIÓN DE INDICADORES DE PRESIÓN MODULO, REVISIÓN DE MANÓMETROS DE PRESIÓN, VERIFICAR LA TENSIÓN DE LA CORREA, CAMBIAR EL FILTRO DEL CARTER SI ESTA OBSTRUIDO, PRUEBAS FUNCIONALES FINALES Y LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO.
COMPRESOR	ODONTOLOGIA REPOSO	1770	SEMESTRAL	-	JUNIO DICIEMBRE	2025	CONTRATISTA	REVISIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y CABLE A.C, INSPECCIÓN VISUAL EXTERNA E INTERNA, VERIFICAR LA VÁLVULA DE SEGURIDAD, INSPECCIÓN DEL FILTRO DE AIRE, VERIFICAR EL PRESOSTATO, REVISIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO, REVISIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO, REVISIÓN DE INDICADORES DE PRESIÓN MODULO, REVISIÓN DE MANÓMETROS DE PRESIÓN, VERIFICAR LA TENSIÓN DE LA CORREA, CAMBIAR EL FILTRO DEL CARTER SI ESTA OBSTRUIDO, PRUEBAS FUNCIONALES FINALES Y LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO.
9.2.6 Equipos de Seguridad								
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

  
 DIRECTOR/GERENTE

  
 JEFE DE ALMACEN